Person 7-1
RT260_RePpt_2
13C_@ CDCl3 {C:\NMRdata} pjs 101

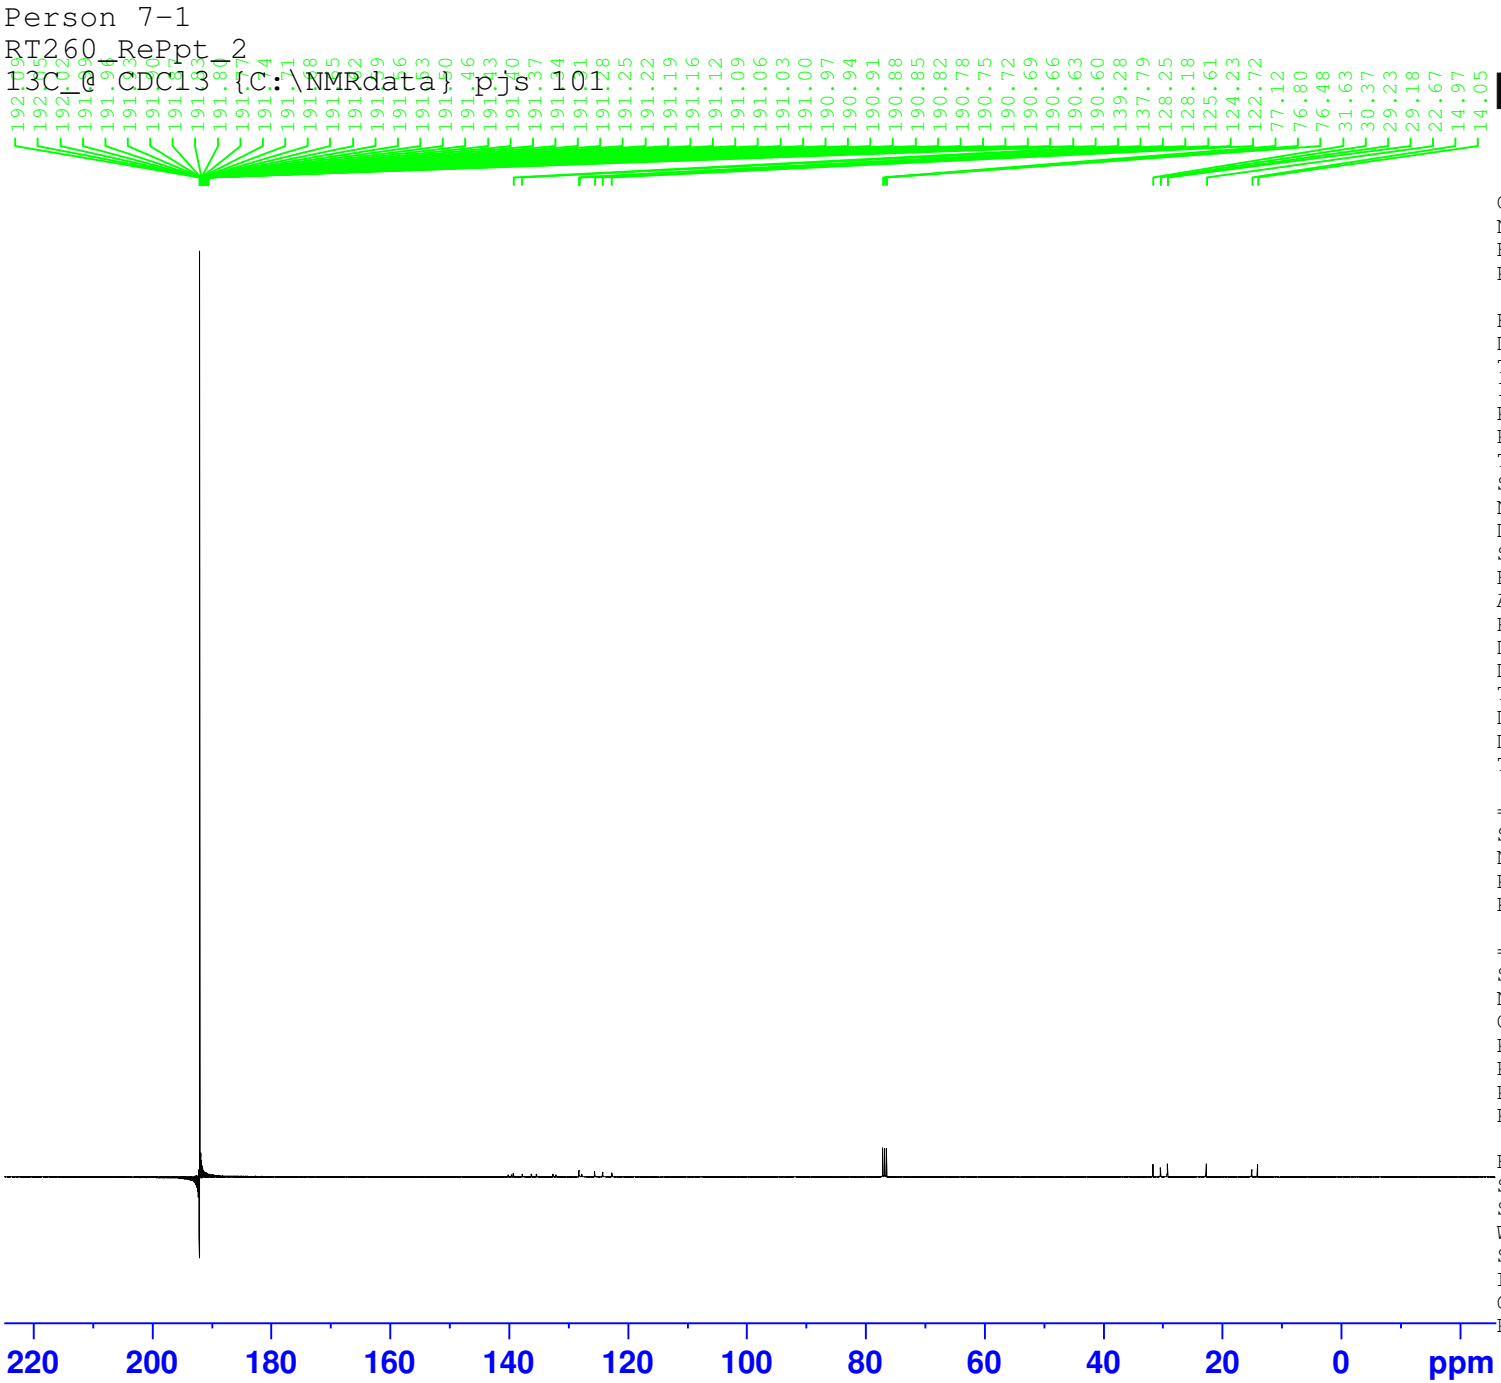

Current Data Parameters
NAME D257966
EXPNO 2
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20160710
Time 19.04
INSTRUM spect
PROBHD 5 mm CPPBBO BB
PULPROG zgpg30
TD 16384
SOLVENT CDCl3
NS 2048
DS 4
SWH 25252.525 Hz
FIDRES 1.541292 Hz
AQ 0.3244032 sec
RG 2050
DW 19.800 usec
DE 18.00 usec
TE 300.0 K
D1 0.69999999 sec
D11 0.03000000 sec
TD0 1

======== CHANNEL f1 ========
SFO1 100.6228298 MHz
NUC1 13C
P1 10.00 usec
PLW1 35.00000000 W

======== CHANNEL f2 ========
SFO2 400.1316005 MHz
NUC2 1H
CPDPRG[2 waltz16
PCPD2 90.00 usec
PLW2 7.50000000 W
PLW12 0.16379000 W
PLW13 0.08238400 W

F2 - Processing parameters
SI 32768
SF 100.6128193 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 1.00 Hz
GB 0
PC 1.40