user Ignas Pakamore
proton.gla CDCl3 /u ignas 4

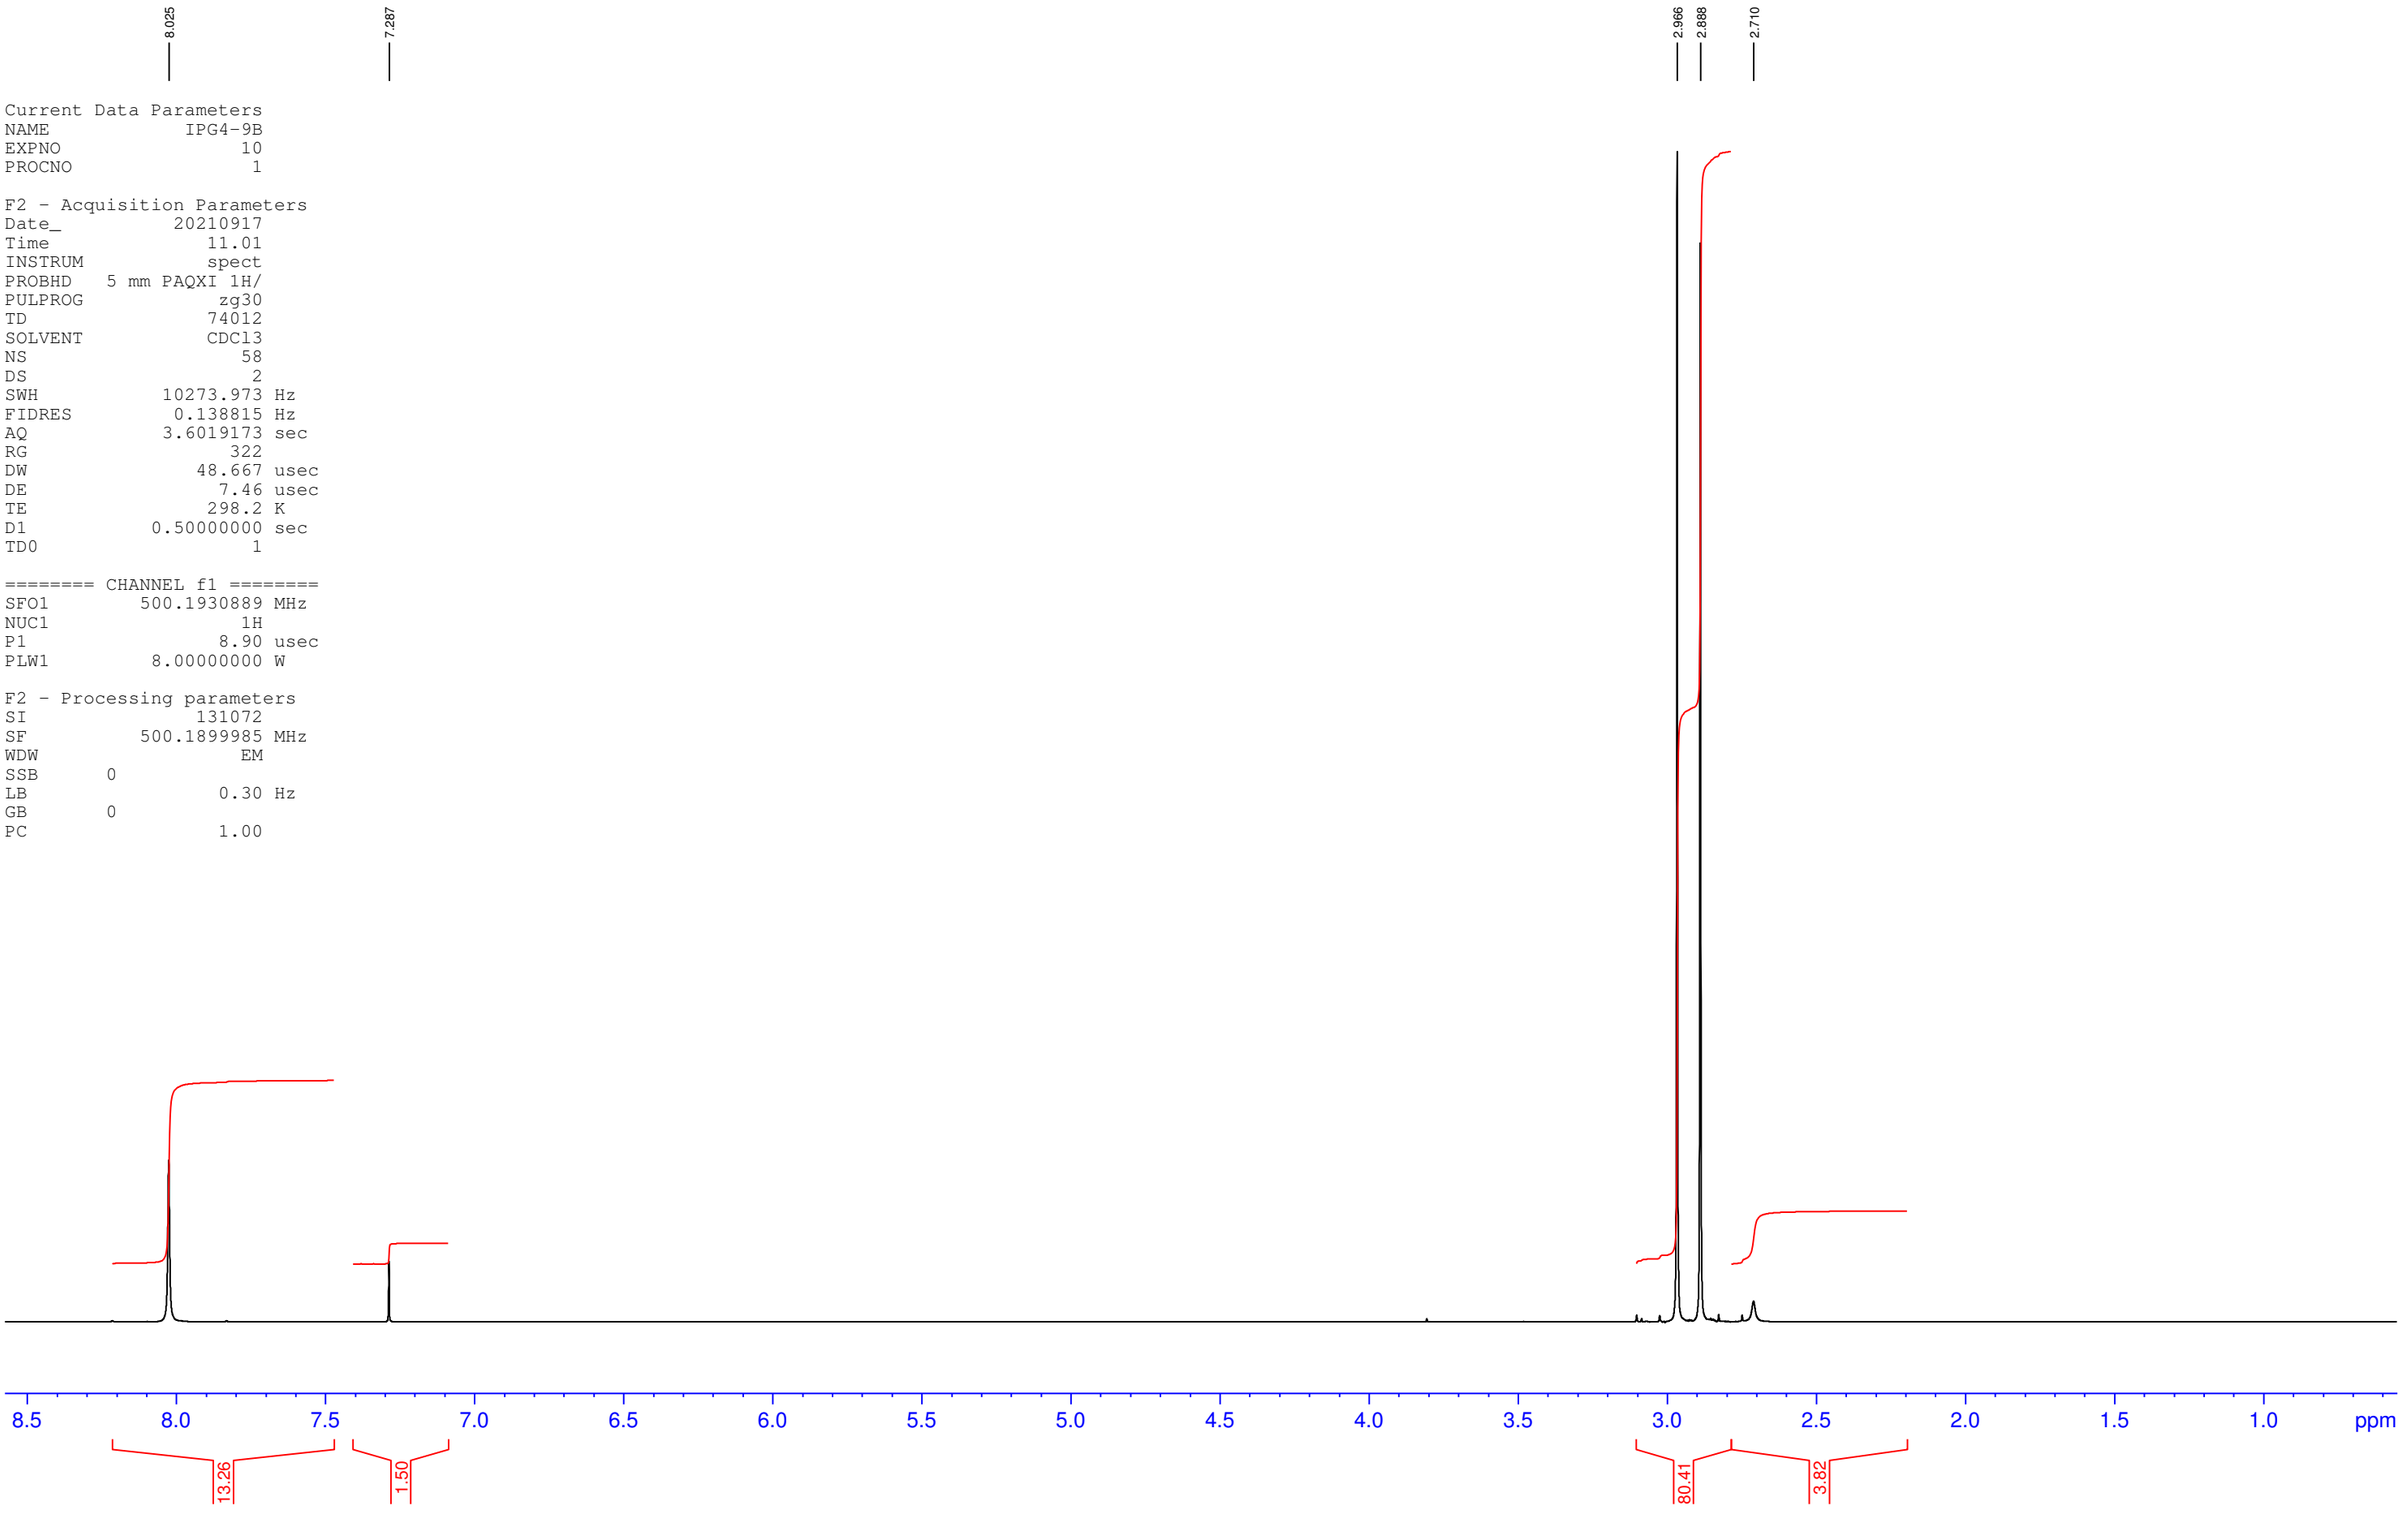
```
Current Data Parameters
NAME             IPG4-9B
EXPNO                 10
PROCNO                 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_           20210917
Time               11.01
INSTRUM            spect
PROBHD   5 mm PAQXI 1H/
PULPROG             zg30
TD                 74012
SOLVENT            CDCl3
NS                    58
DS                     2
SWH            10273.973 Hz
FIDRES          0.138815 Hz
AQ             3.6019173 sec
RG                   322
DW                48.667 usec
DE                 7.46 usec
TE                298.2 K
D1            0.50000000 sec
TD0                    1

======== CHANNEL f1 ========
SFO1         500.1930889 MHz
NUC1                  1H
P1                  8.90 usec
PLW1          8.00000000 W

F2 - Processing parameters
SI                131072
SF           500.1899985 MHz
WDW                   EM
SSB       0
LB                 0.30 Hz
GB        0
PC                 1.00
```